



Inštitut za mlekarstvo in probiotike
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**Medlaboratorijska primerjava STRP
SUROVO MLEKO – MID-IR spektrometrija**

September 2016


Serijska številka vzorcev: 5776-0916 (maščoba, beljakovine, laktoza) in 5777-0916 (sečnina)

Poročilo je bilo izdano na željo stranke.

Domžale, 24.10.2016

MAŠČOBA


Slika 1: Točnost MAŠČOBA - grafični prikaz.

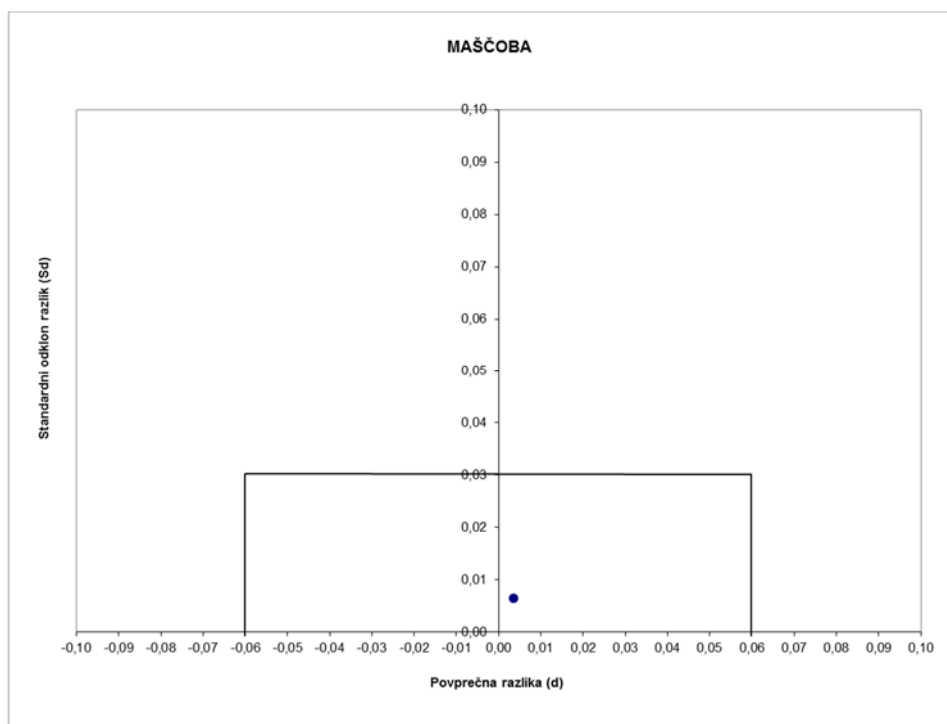

Meje: $d = \pm 0,06 \text{ g/100 g}$ $Sd = 0,03 \text{ g/100 g}$

BELJAKOVINE


Slika 2: Točnost BELJAKOVINE - grafični prikaz.

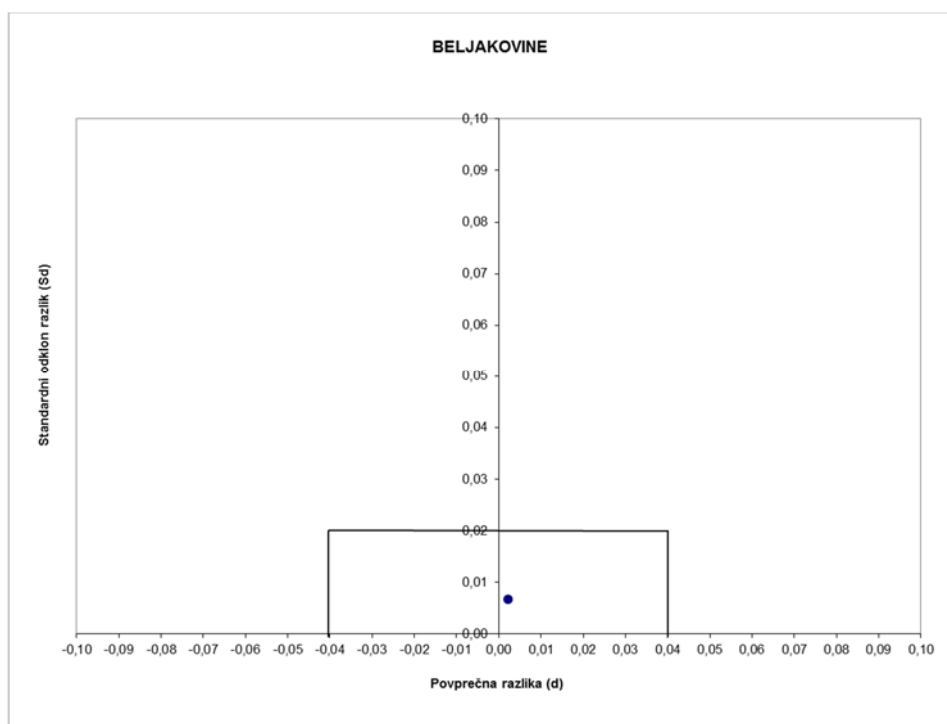

Meje: $d = \pm 0,04 \text{ g/100 g}$ $Sd = 0,02 \text{ g/100 g}$

LAKTOZA


Slika 3: Točnost LAKTOZA - grafični prikaz.

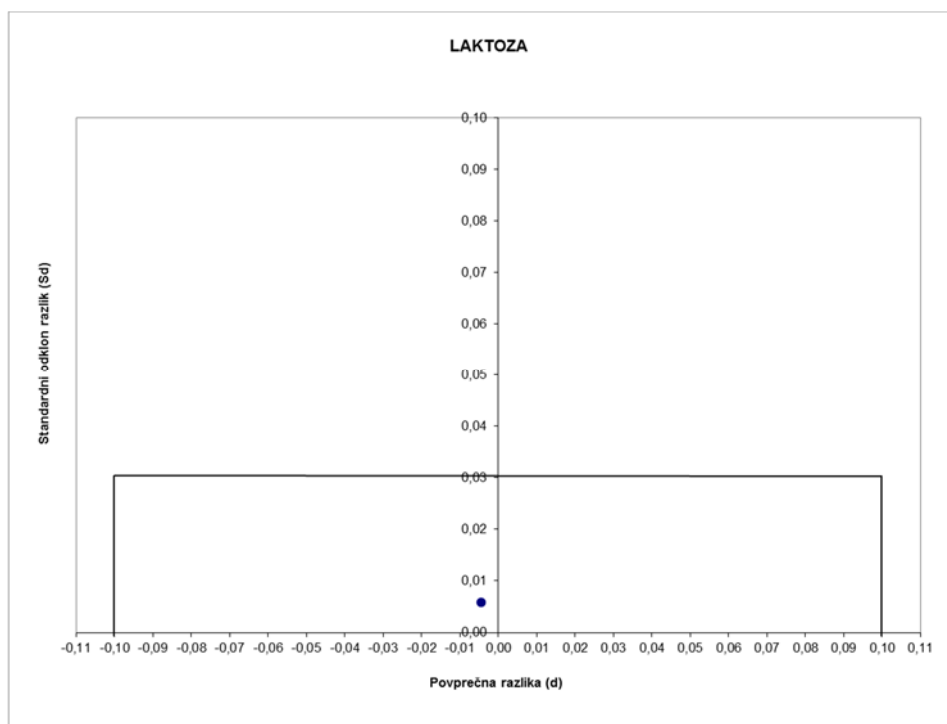

Meje: $d = \pm 0,10 \text{ g/100 g}$ $Sd = 0,03 \text{ g/100 g}$

SEČNINA

Slika 4: Točnost SEČNINA - grafični prikaz.



Meje: $d = \pm 3,00 \text{ mg/100 ml}$ $Sd = 1,50 \text{ mg/100 ml}$